

Laborgeräte aus Metall

Stativklammern

DIN
12894

ICS 71.040.20

Ersatz für Ausgabe 1978-10

Deskriptoren: Laborgerät, Metall, Stativklammer

Metal laboratory ware — Clamps

Equipement métallique de laboratoire — Pincés

Vorwort

Diese Norm wurde im Normenausschuß Laborgeräte und Einrichtungen erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe Oktober 1978 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Werkstoffe für Klammern und Schrauben an den Stand der Technik angepaßt;
- b) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 12894: 1957-02, 1978-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Maße, Werkstoffe und Ausführung von Stativklammern zur Befestigung von Laborgeräten an Laborstativen fest.

Fortsetzung Seite 2 und 3


Normenausschuß Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

2 Maße, Bezeichnung

Die Klemmen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

Maße in mm

Form A eckig

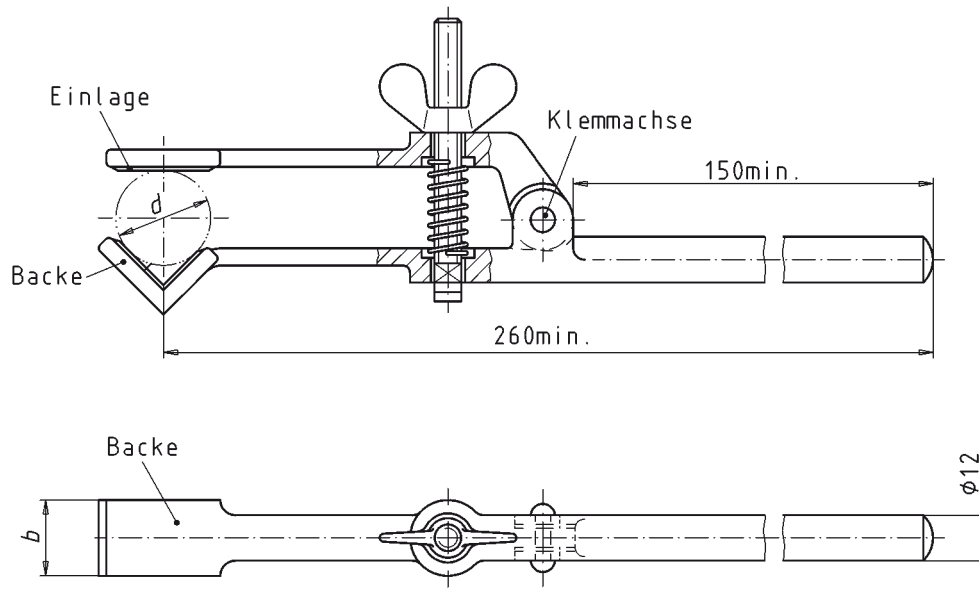

Form B rund

